




Doser la thyroxine avec le test rapide Fassisi® T4



RAPIDE

Resultat du test après **10 minutes.**

SIMPLE

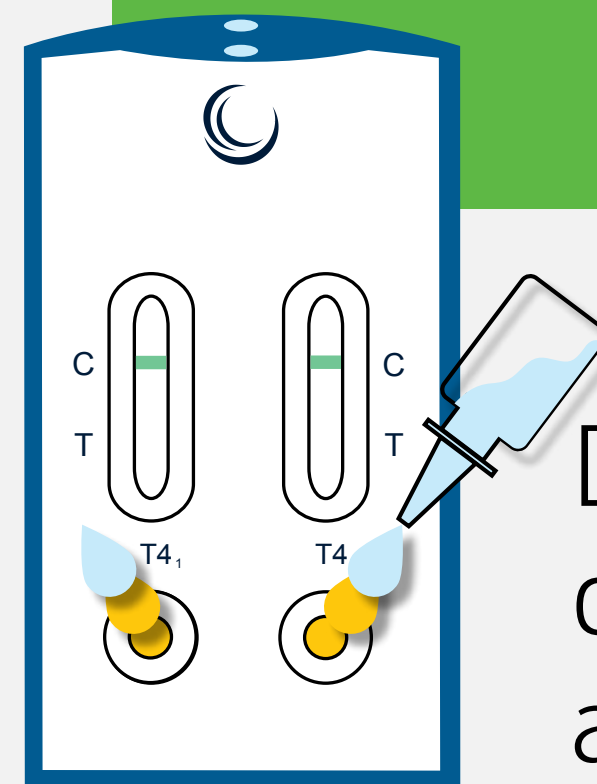

Déposer le plasma/serum dans le puits échantillon, ajouter le réactif

NORMALE

LÉGÈREMENT AUGMENTÉE

FORTEMENT AUGMENTÉE

vidalta



10 mg



15 mg

BON MARCHÉ

Emballage à 5 tests **CHF 35.40**

► **Prix pour un test CHF 7.08**

**PLUS. VALUE.
RESPONSABILITÉ.**

